

6

Je ziet de vastgelegde meetwaardes op 2 schermen

Rookgas 2		
O2	4,5 Vol%	4,5
CO	22 ppm	22
T-G	57,0 °C	57,0
CO2	9,2 Vol%	9,2
CO-0%	28 ppm	28
CO	32 mg/m3	32
T-Dauw	53 °C	53
← →		
Hold Annuleren		

7

Rookgasanalyse. Het eindresutaat, druk op klaar in het scherm. De meting is nu voltooid. Je kunt verwerken (printen, oplaan etc.) of annuleren (stoppen of verder gaan met de meting)

Rookgasanalyse	
T-SL	57,0 °C
O2-SL	4,5 V%
T-G	57,0 °C
O2	4,5 Vol %
CO	22 ppm
CO2	9,2 Vol %
Perdita	0,0 %
CO-0%	28 ppm
→	
Verwerken Annuleren	

Rookgasanalyse	
CO	32 mg/kWh
T.Rug.	52,8 °C
In.aria.	1,27
Eta	100,0 %
P-Trek	-15 Pa
T-Ketel	60 °C
← →	
Verwerken Annuleren	

Invoeren - input	
T-Ketel	60 °C
Meting beëindigen? Ja Nee	
← →	
Klaar Annuleren	

Volg ons ook op



Lennart Pit
Specialist handmeters

+31 (0)36 535 06 51 - lpit@hitma.nl - www.hitma-handmeters.nl 01100010
www.hitma.nl/lennart



Hitma **Handmeters**

Fotohandleiding

Dräger FG-4500

Fotohandleiding
rookgasmeting




1

Aanzetten van de meter



2

Rookgasanalyse starten

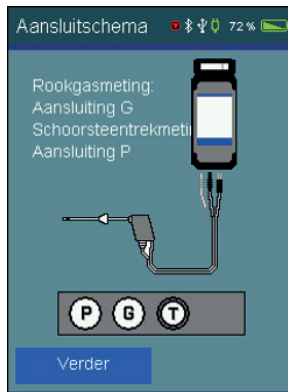

4

Rookgas1: Controleren en vastleggen van omgevingswaarden.

Goed bij $\pm 20,9\%$ O₂ dan HOLD

3

Brandstof selecteren

Voor NL: Aardgas L (L = Gronings aardgas)



5

Rookgas 2 en 3. Meetlans in meetpunt ketel plaatsen en meten. (Punt 6 meting vastleggen)

